

診断X線の入射表面線量計算ソフト

Sdec_FV

(Surface dose evaluation code, Final version)

操作マニュアル

2023

Sdec_FV の起動

エクスプローラ等から Sdec_FV.exe を起動して下さい。



英語版（English edition）、または日本語版（Japanese edition）を選択して下さい。
（以下、日本語版について取り扱い方法を解説していきます。）

Sdec_FV 操作マニュアル

最初に起動すると下左図に示す画面が表示されます。

黄色ボタン を押して、ユーザーの名称を入力して下さい（右図）。

背面窓にユーザー名が表示されます。

Sdec_V (Surface Dose Evaluation Code, Final Version)

診断X線の入射表面線量計算

2023-09-10 です

高電圧整流方式
○ 定電圧・インバータ
○ 三相12ピーク
○ 単相全波

照射部位 追加・削除 腹部正面

X線管電圧 75 kV
付加フィルタ (Al) 1.0 mm
付加フィルタ (Cu) 0 mm

任意フィルタ 設定・解除
— 0 mm

X線管電流 透視 200 mA
照射時間 0.05 sec
焦点-受像器間 100 cm
被写体厚 20 cm
焦点-入射表面間 80 cm
照射野の大きさ 半切サイズ 縦
長軸方向サイズ 43.2 cm
単軸方向サイズ 35.6 cm

ターゲット角度 12 度
固有フィルタ (Al当量) 2.5 mm

後方散乱係数
軟部組織吸収線量に基づく
皮膚組織吸収線量に基づく
空気カーマに基づく

照射線量 - 吸収線量 変換係数
軟部組織 Gy/C/kg
皮膚組織 Gy/C/kg
空気カーマ Gy/C/kg

実効線量の概算 (オプション)
実効線量概算 結果表に追加
実効線量 mSv

ようこそ Sdec_V へ：最初にユーザー名を登録して下さい

入射表面線量の計算 この条件で計算する 結果表に追加 結果表を見る 終了

ようこそ Sdec_V へ
ユーザー名を入力して下さい

本名, ニックネーム, 施設名, グループ名 など
漢字, アルファベット, 数字, 記号 何でも OK

鈴木 昇一郎

OK Cancel

初期画面上右端のマスコット犬をダブルクリックすると
ユーザー名を変更できます

右上のマスコット犬をダブルクリックすると、ユーザー名を変更することができます。

ユーザー名が登録してあれば、次回からは **黄色ボタン** は表示されません。

メイン画面（照射条件などの入力および計算結果の表示）

Sdec_V (Surface Dose Evaluation Code) : 加藤 秀起

診断X線の入射表面線量計算

2023-09-10 です

高電圧整流方式
○ 定電圧・インバータ
○ 三相12ピーク
○ 単相全波

照射部位 追加・削除 腹部正面

X線管電圧 75 kV
付加フィルタ (Al) 1.0 mm
付加フィルタ (Cu) 0 mm

任意フィルタ 設定・解除
— 0 mm

X線管電流 透視 200 mA
照射時間 0.05 sec
焦点-受像器間 100 cm
被写体厚 20 cm
焦点-入射表面間 80 cm
照射野の大きさ 半切サイズ 縦
長軸方向サイズ 43.2 cm
単軸方向サイズ 35.6 cm

ターゲット角度 12 度
固有フィルタ (Al当量) 2.5 mm

後方散乱係数
軟部組織吸収線量に基づく
皮膚組織吸収線量に基づく
空気カーマに基づく

照射線量 - 吸収線量 変換係数
軟部組織 Gy/C/kg
皮膚組織 Gy/C/kg
空気 33.97 Gy/C/kg

入射表面線量
軟部組織吸収線量 mGy
皮膚組織吸収線量 mGy
空気カーマ mGy

実効線量の概算 (オプション)
実効線量概算 結果表に追加
実効線量 mSv

出力データ sdec_default
出力データ編集 出力データ選択

後方散乱係数 算出方法
○ 平面として計算 (微分後方散乱係数を用いて計算)
○ 頭部以外 ○ 頭部
○ 非平面として計算 (円柱, 楕円柱, レーストラックモデルで直接モンテカルロ計算) (被射体はICRU軟部組織)

入射表面線量の計算 この条件で計算する 結果表に追加 結果表を見る 終了

入力項目

- 高電圧整流方式

使用装置に合わせて下記より選択して下さい。

- (1) 定電圧・インバータ
- (2) 三相 12 ピーク
- (3) 単相全波

- X線管ターゲット角度（装置の仕様書記載値を入力して下さい）
- 固有フィルタ（絞り機構を含めた公称アルミニウム当量）


- 撮影部位

プルダウンメニューから選択して下さい。

撮影部位がメニューにない場合

追加・削除 を押すと右に示す画面が表示されます。部位の追加・削除を行って下さい。

（後述の実効線量概算に使用する新規追加した撮影部位のデータは、別途作成する必要があります。作成方法は **実効線量** の項を参照して下さい。）

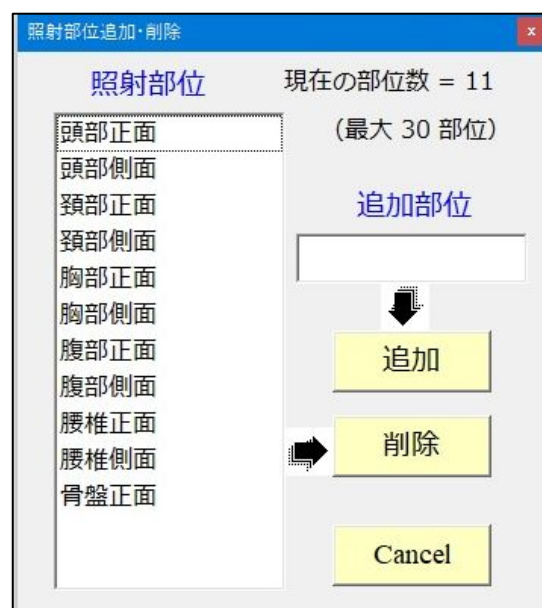


- X線管電圧
- 付加フィルタ（アルミニウム）
- 付加フィルタ（銅）
- 任意フィルタ（アルミ、銅以外のフィルタを用いる場合）

任意フィルタ を押すと右図画面が表示されます。


フィルタ材質を選択し、厚さを入力して下さい。任意材質のフィルタを使用する場合、その材質（元素等）の相互作用断面積データが必要です。別ソフト Phics をダウンロードし、その中のフォルダ ele もしくは mix の中から、必要な材質

（元素等）のデータを、本ソフトと同じフォルダにコピーしておいて下さい。一例として配付ファイルの中にタンタルのデータ(73_Ta.ele) を入れてあります。

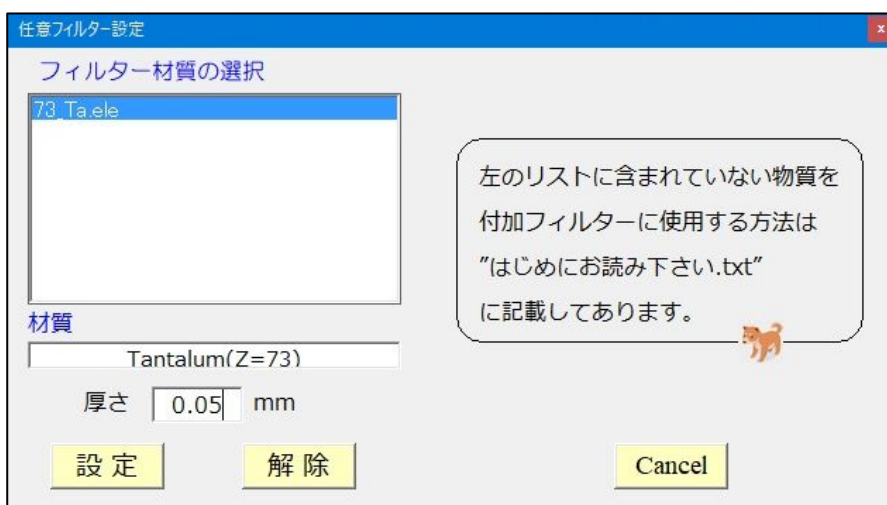

- X線管電流

透視の場合 **透視** を押すと右画面が表示されます。画面にしたがって平均管電流を算出し **OK** ボタンを押して下さい。

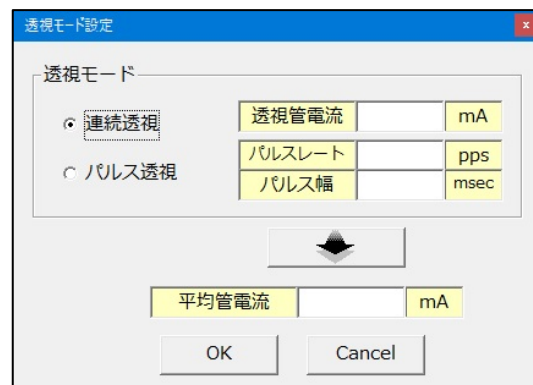

透視モード設定画面。透視モードを選択すると、透視管電流 (mA)、パルスレート (pps)、パルス幅 (msec) の入力欄が表示されます。また、平均管電流 (mA) の入力欄と OK、Cancel ボタンも表示されます。

- 照射時間

- 焦点 - 受像器間距離 (FID)

- 被写体厚

- 焦点 - 入射表面間距離 (FSD)

- 受像器面での照射野サイズ

プルダウンメニューから画像サイズを選択すると、下の照射野サイズ欄にその大きさが自動表示されます。その他もしくは円形照射野を選択した場合、照射野サイズ欄は空白になります。

- 照射野サイズ (長軸方向)

- 照射野サイズ (短軸方向)


なるべく正確な大きさを入力して下さい。照射野サイズが表示されていても数値を書き換えることができます。

- X線焦点から 1 m の距離の照射線量

下記から選択して下さい。

(1) 実測値を直接入力 (推奨)

(2) デフォルト出力データを利用

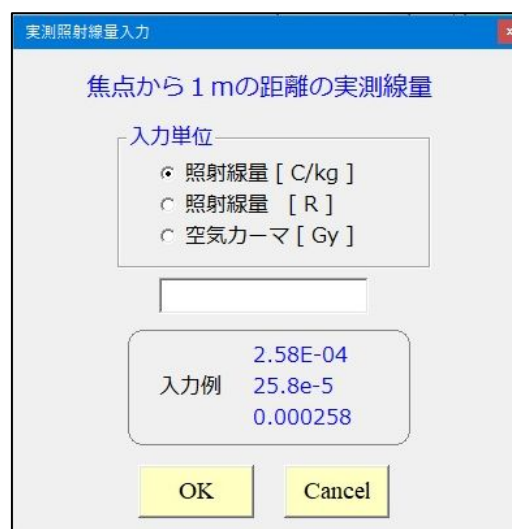

実測照射線量入力画面。焦点から 1 m の距離の実測線量を入力する画面です。入力単位として、照射線量 [C/kg]、照射線量 [R]、空気カーマ [Gy] が選択できます。入力例として 2.58E-04、25.8e-5、0.000258 が示されています。

(1) を選択すると右図の実測値入力画面が表示されますので、測定器の単位に合わせ、入力例にしたがって実測値 (線量計の指示値に校正定数、補正係数を乗じた値) を入力して下さい。1 m 以外の距離で測定した場合、距離の逆自乗則により、距離 1 m の線量に換算して入力して下さい。

(2) を選択すると多施設を対象にして調査されたデータの平均的な出力が、照射条件に合わせて自動計算されます。

各施設で装置ごとに出力データを作成し、その出力データを利用することもできます。

出力データ編集 を押すと右図の画面が表示されます。対象とする整流方式、管電圧範囲の出力を実測し、データ表の値を



平均出力データ編集画面。X線焦点から 1 m の距離における単位 mAs 当たりの照射線量 [C/kg] を表示する画面です。表には kV、定電圧、三相12パルス、単相全波のデータが示されています。

kV	定電圧	三相12パルス	単相全波
40	3.22E-07	2.48E-07	1.33E-07
50	5.44E-07	4.45E-07	2.32E-07
60	8.41E-07	6.93E-07	3.96E-07
70	1.19E-06	1.01E-06	6.45E-07
80	1.66E-06	1.43E-06	9.11E-07
90	2.13E-06	1.83E-06	1.19E-06
100	2.67E-06	2.28E-06	1.48E-06
110	3.12E-06	2.67E-06	1.76E-06
120	3.74E-06	3.10E-06	2.06E-06
130	4.26E-06	3.61E-06	2.32E-06
140	4.77E-06	4.00E-06	2.71E-06
150	5.29E-06	4.51E-06	2.97E-06

測定時の固有を含む濾過 [mm]

アルミ	銅
3.00	0.00
3.00	0.00
3.00	0.00

コメント: Sdec default data

ファイル名: sdec_default (ファイル名は、拡張子なしで入力して下さい)

Save Cancel

書き換えて下さい。

(測定の際、全管電圧で付加フィルタは一定として下さい)

出力データを変更したら、出力データファイル名およびコメントを入力し保存して下さい。

出力データ選択 を押し、使用する出力データファイルを選択して下さい。

• 後方散乱係数算出方法

下記より選択して下さい。

1) 平面として計算 (微分後方散乱係数法) 次の (1),(2) から選択

(a) 頭部専用 (b) 頭部以外

2) 円柱または楕円柱モデル等として直接モンテカルロ計算

1) (a) 頭部専用 を選択した場合

入射面から深さ 5mm まで ICRU soft-tissue 層、次に厚さ 5mm の骨層 (平均密度 1.50 g/cm^3 と設定)、骨層以下は ICRU soft-tissue としたファントムで計算されたデータを基にして

1) (2) 頭部以外 を選択した場合

均質 ICRU soft-tissue ファントムで計算されたデータを基にして微分後方散乱係数法により後方散乱係数が計算されます。

2) を選択した場合、下図画面が表示されます。入射面形状を、円柱形、楕円柱形、レーストラック形から選択し、模式図にしたがって半径などのサイズを入力して下さい。

Shape Check ボタンで入射面の形状を確認できます。

モンテカルロシミュレーションの入射光子数をプルダウンメニューから選択、もしくは直接入力し、**OK** を押して下さい。

入射光子数を大きく設定すると、計算の統計変動による誤差は小さくなりますが、計算に要する時間は長くなります。

Surface type

Select surface type

☒ Cylindrical type

Curvature radius cm

☐ Elliptic cylinder type

Horizontal axis cm

Vertical axis cm

☐ Racetrack type

a = cm

b = cm

Length = cm

Shape Check

Photon history of MC calculation =

OK Cancel

すべての項目を入力し **この条件で計算する** を押すと、計算が開始されます。

後方散乱係数算出方法で「円柱または楕円柱モデル等」を選択した場合、モンテカルロシミュレーションが終了するまで、一切の操作を行わないで下さい。

計算が終了すると、画面右側の欄（下図の赤枠）に計算結果が表示されます。

Sdec-V (Surface Dose Evaluation Code) : 加藤 秀起

診断X線の入射表面線量計算

2023-09-10 です

高電圧整流方式
☒ 定電圧・インバータ
☐ 三相12ピーク ☐ 単相全波

照射部位 追加・削除 胸部正面

X線管電圧 130 kV
 付加フィルタ (Al) 1.5 mm
 付加フィルタ (Cu) 0.15 mm
 任意フィルタ 設定・解除
 — 0 mm

X線管電流 透視 100 mA
 照射時間 0.05 sec
 焦点-受像器間 200 cm
 被写体厚 20 cm
 焦点-入射表面間 180 cm
 照射野の大きさ 大角サイズ
 長軸方向サイズ 35.6 cm
 単軸方向サイズ 35.6 cm

ターゲット角度 12 度
 固有フィルタ (Al当量) 2.5 mm

焦点から1 mの距離の照射線量
☒ 実測値を直接入力 (推奨)
☐ デフォルト出力データを利用
 照射線量 at 1 m 1.06E-5 C/kg

出力データ sdec_default
出力データ編集 出力データ選択

後方散乱係数 算出方法
☒ 平面として計算 (微分後方散乱係数を用いて計算)
☐ 非平面として計算 (円柱, 楕円柱, レーストラックモデルで直接モンテカルロ計算) (被射体はICRU軟部組織)
☒ 頭部以外 ☐ 頭部

後方散乱係数

軟部組織吸収線量に基づく	1.583
皮膚組織吸収線量に基づく	1.581
空気カーマに基づく	1.603

照射線量 - 吸収線量 変換係数

軟部組織	34.08	Gy/C/kg
皮膚組織	33.90	Gy/C/kg
空 気	33.97	Gy/C/kg

入射表面線量

軟部組織吸収線量	0.18	mGy
皮膚組織吸収線量	0.17	mGy
空気カーマ	0.18	mGy

実効線量の概算 (オプション)
実効線量概算 結果表に追加
 実効線量 mSv

入射表面線量の計算 この条件で計算する 結果表に追加 結果表を見る 終了

計算結果一覧

- ・ 後方散乱係数 (軟部組織吸収線量に基づく)
- ・ 後方散乱係数 (皮膚組織吸収線量に基づく)
- ・ 後方散乱係数 (空気カーマに基づく)
- ・ 照射線量 - 吸収線量変換係数 (軟部組織を対象)
- ・ 照射線量 - 吸収線量変換係数 (皮膚組織を対象)
- ・ 照射線量 - 吸収線量変換係数 (空気を対象, 33.79 一定)
- ・ 入射表面線量 (軟部組織吸収線量)
- ・ 入射表面線量 (皮膚組織吸収線量)
- ・ 入射表面線量 (空気カーマ÷空気吸収線量)

計算終了後 結果表に追加 を押すと、次頁図に示すように照射条件、計算結果等が一覧表に書き込まれます (最大 15 撮影条件)。結果表は、印刷、保存、読み出しができます。それぞれ指示に従って行って下さい。

撮影部位ごとに、照射野内に含まれる臓器、その深さ、照射容積に含まれる割合のデフォルト値が表示されますので、適当に修正して下さい。**OK** を押すと実効線量の概算値が表示されます。

ただし、撮影部位の選択でプルダウンメニューにない部位を追加した場合、その部位についてのデフォルト値がありませんので、右図の白枠内の数値はすべて0と表示されます。

撮影部位に合わせて適当な数値を入力し、**OK** を押して下さい。

Effective Dose

実効線量の概算 (参考データ)

腹部正面 被写体厚 = 20 cm

組織・臓器	組織荷重係数 W_T	組織・臓器の厚さ 表面からの深さ cm	対象組織のうち 照射容積に含まれる 割合 %	組織等価線量 μSv
<input type="checkbox"/> 乳房	0.12	0 ~ 0	0	-
<input checked="" type="checkbox"/> 骨髄(赤色)	0.12	12.0 ~ 17.0	25	2.4
<input checked="" type="checkbox"/> 結腸	0.12	5.0 ~ 15.0	100	24.3
<input checked="" type="checkbox"/> 肺	0.12	5.0 ~ 15.0	10	4.0
<input checked="" type="checkbox"/> 胃	0.12	8.0 ~ 10.0	100	25.7
<input checked="" type="checkbox"/> 生殖腺	0.08	10.0 ~ 10.0	100	13.6
<input type="checkbox"/> 甲状腺	0.04	0 ~ 0	0	-
<input checked="" type="checkbox"/> 食道	0.04	15.0 ~ 15.0	10	0.3
<input checked="" type="checkbox"/> 肝臓	0.04	3.0 ~ 10.0	100	14.1
<input checked="" type="checkbox"/> 膀胱	0.04	5.0 ~ 8.0	100	13.5
<input checked="" type="checkbox"/> 骨表面	0.01	10.0 ~ 10.0	30	0.5
<input checked="" type="checkbox"/> 入射皮膚面	0.01	0.0 ~ 0.0	40	3.5
<input checked="" type="checkbox"/> 射出皮膚面	0.01	20.0 ~ 20.0	40	0.1
<input type="checkbox"/> 脳	0.01	0 ~ 0	0	-
<input type="checkbox"/> 唾液腺	0.01	0 ~ 0	0	-
<input type="checkbox"/> 残りの組織	0.12	0 ~ 0	0	-

Reset OK 合計 (実効線量) = 0.102 mSv

データ入力方法

- (1) 照射野に含まれる組織・臓器にチェックを入れる
- (2) 対象組織・臓器の入射表面からの深さを入力する
(肺は密度を 0.3 として自動的に実効深に換算される)
- (3) 対象組織・臓器の全容積のうち照射野に含まれる割合を入力する

入力が完了したら OK ボタンを押す

各撮影部位のデフォルト値は Organ-data フォルダ内に、部位別に csv フォーマットで納められており、下図に示すように Microsoft Excel で修正、新規作成することができます。

entral-Axis Depth Dose for Diagnostic X-rays

Effective Dose

実効線量の概算 (参考データ)

胸部正面 被写体厚 = 20 cm

組織・臓器	組織荷重係数 W_T	組織・臓器の厚さ 表面からの深さ cm	対象組織のうち 照射容積に含まれる 割合 %
<input checked="" type="checkbox"/> 乳房	0.12	16.0 ~ 20.0	100
<input checked="" type="checkbox"/> 骨髄(赤色)	0.12	5.0 ~ 5.0	20
<input type="checkbox"/> 結腸	0.12	0 ~ 0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 肺	0.12	5.0 ~ 15.0	100
<input checked="" type="checkbox"/> 胃	0.12	10.0 ~ 10.0	20
<input type="checkbox"/> 生殖腺	0.08	0 ~ 0	0
<input type="checkbox"/> 甲状腺	0.04	0 ~ 0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 食道	0.04	5.0 ~ 5.0	100
<input checked="" type="checkbox"/> 肝臓	0.04	10.0 ~ 15.0	20
<input checked="" type="checkbox"/> 膀胱	0.04	0 ~ 0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 骨表面	0.01	10.0 ~ 10.0	5
<input checked="" type="checkbox"/> 入射皮膚面	0.01	0.0 ~ 0.0	30
<input checked="" type="checkbox"/> 射出皮膚面	0.01	20.0 ~ 20.0	30
<input type="checkbox"/> 脳	0.01	0 ~ 0	0
<input type="checkbox"/> 唾液腺	0.01	0 ~ 0	0
<input type="checkbox"/> 残りの組織	0.12	0 ~ 0	0

Reset OK 合計 (実効線量) = 0

データ入力方法

- (1) 照射野に含まれる組織・臓器にチェックを入れる
- (2) 対象組織・臓器の入射表面からの深さを入力する
(肺は密度を 0.3 として自動的に実効深に換算される)
- (3) 対象組織・臓器の全容積のうち照射野に含まれる割合を入力する

入力が完了したら OK ボタンを押す

胸部正面.csv - Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1	乳房	1	2	4	2	0	100
2	骨髄	1	0	5	0	5	20
3	結腸	0	0	0	0	0	0
4	肺	1	0	5	2	5	100
5	胃	1	1	0.5	1	0.5	20
6	生殖腺	0	0	0	0	0	0
7	甲状腺	0	0	0	0	0	0
8	食道	1	0	5	0	5	100
9	肝臓	1	2	10	2	5	20
10	膀胱	0	0	0	0	0	0
11	骨表面	1	1	0.5	1	0.5	5
12	入射皮膚	1	0	0	0	0	30
13	射出皮膚	1	2	0	2	0	30
14	脳	0	0	0	0	0	0
15	唾液腺	0	0	0	0	0	0
16	残り組織	0	0	0	0	0	0
17							
18	組織・臓器	Check	深さ(1)D		深さ(2)F	割合	
19			0:D=D		0:F=F		
20			1:D=Th*D		1:F=Th*F		
21			2:D=Th-D		2:F=Th-F		
22							
23							

以上